



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 22.01.2018r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych – znak 60/med/2017** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 21.12.2017r pod numerem 635289-N-2017

Pytanie 1 dotyczące Zadania 1 poz. 1-3

Czy zamawiający w celu ułatwienia przeprowadzenia poprawnej procedury zakładanie gipsu zgodzi się na warunek konieczny posiadania przez opaski gipsowe plastikowego perforowanego trzpienia, który umożliwi równomierne namaczanie opaski oraz zapobiega jej deformacji ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 2 dotyczące Zadania 4 poz 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania chusty trójkątnej bawełnianej czy włókninowej?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chusty trójkątnej bawełnianej jak i włókninowej.

Pytanie 3 dotyczące Zadania 8 poz 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy wstępnie pranej, w procesie technologicznym wielokrotnie płukanej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 dotyczące Zadania 10 poz 1

Czy zamawiający dopuści chłonne serwety operacyjne w kolorze białym z nitką RTG oraz tasiemką w rozmiarze 45x45 cm lub 50x50 cm lub 45x70cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwety w rozmiarze 45 x 70 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie 5 dotyczące Zadania 17 poz 5,6

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem kauczukowym z zawartością tlenku cynku, który chroni skórę przed podrażnieniami?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 6 dotyczące Zadania 23, poz 1

Czy Zamawiający dopuści tupfer w kształcie kuli o wykroju 20x20?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 7 dotyczące Zadania 25, poz 1

Czy Zamawiający dopuści tupfer w rozmiarze 15x15cm w kształcie kuli?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 8 dotyczące Zadania 31 poz 1

Czy zamawiający dopuści opatrunki jałowe pooperacyjne z klejem hypoalergicznym typu hot-melt (kauczuk syntetyczny), z wkładem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany warstwą mikroperforowanej folii polietylenowej, z przecięciem wzdłuż dłuższego lub krótszego boku w zależności od rozmiaru plastra?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 9 dotyczące Zadania 8, 9, 10, 12, 13, 15 poz 2, 23, 25, 26:

Czy produkt w wyżej wymienionych zadaniach muszą być wysterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji?

Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np. bawełna tkaniny, gaza), ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w metodę sterylizacji.

Pytanie 10 dotyczące Zadania 36, poz.1

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zamawiający wydzieli pozycję nr 1 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo ?

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 36 poz.1 i tworzy z niej Zadanie 36A.

Pytanie 11 dotyczące Zadania 36 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątne, wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubości nici 0,16 mm, grubości siatki 0,47 mm, powierzchnia porów 0,59 mm² porowatość 590 µm, gramatura 80 g/m² (+- 10g/m²), rozmiar 8cmx13cm oraz 10cmx16cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 12 dotyczące Zadania 38 poz 1

Czy zamawiający dopuści: Siatki przepuklinowe polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłaniałne nadające się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem, dzięki powłoce tytanowej mają właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegają do trzewi). Nadają się do wszystkich technik operacyjnych. W rozmiarach odpowiednio: 15x15cm, 20x15cm, 30x30cm – wszystkie pakowane po 3 szt.?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 13 dotyczące Zadania 38, poz 2

Czy zamawiający dopuści: Siatki przepuklinowe polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłaniające nadające się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem, dzięki powłoce tytanowej mają właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegają do trzewi). Nadają się do wszystkich technik operacyjnych, o następujących parametrach: waga 16 g/m², grubość nici (włókna) 65 μm, wielkość porów ≥ 1mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 14 dotyczące Zadania 41

Czy Zamawiający dopuści taśmę o gramaturze 64 g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 15 dotyczące Zadania 41

Prosimy o doprecyzowanie ilu sztuk narzędzi wielorazowych zamawiający wymaga na bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy. Ma to istotne znaczenie do kalkulacji cenowej oferty.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga ilości narzędzi wielorazowych stosownej do bezpiecznego wykonania zabiegu.

Pytanie 16 dotyczące Zadania 50, poz.1

Czy zamawiający dopuści maseczkę odporną na przesiąkanie, hypoalergiczną zgodną z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typ II, o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8 % aerozoli biologicznych, z trokami o długości min. 35 cm, wyposażone w sztywnik, pakowane w kartonik, po 50 sztuk, na pudełku numer katalogowy oraz numer LOT? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 17 dotyczące Zadania 50, poz 2:

Czy zamawiający dopuści maseczkę odporną na przesiąkanie, hypoalergiczną zgodną z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typ II, o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8 % aerozoli biologicznych, z gumką, wyposażone w sztywnik, pakowane w kartonik, po 50 sztuk, na pudełku numer katalogowy oraz numer LOT? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 18 dotyczące Zadania 51 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną na stolik MAYO wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40 kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 19 dotyczące Zadania 55, poz 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75 cm z przylepcem wokół otworu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 20 dotyczące Zadania 57, poz 1:

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta z przylepcem	1	240x150cm
Serweta z przylepcem	1	180x170cm
Serweta z przylepcem- przylepiec na szerszym boku	2	90x75 cm
Taśma medyczna	1	50x9 cm
Serweta na stół instrum.	1	190x150cm
Serweta na stolik Mayo	1	145x80cm
Serwetki do rąk	2	40x20 cm

Serwety z przylepcem wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g/m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75 N i chłonności 570%, serweta sterylna nas tolik Mayo wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałość na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40 kPa, barierowość dla wody imn 30 cm H₂O, serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 21 dotyczące Zadania 51 poz. 3-5 oraz 7-9, zadanie 54, zadanie 55

Czy zamawiający dopuści serwety i obłożenia wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g/m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250 cm H₂O wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment w: Zadaniu 51 poz. 3-5 oraz 7-9, Zadaniu 54, Zadaniu 55.

Pytanie 22 dotyczące Zadania 58

Czy zamawiający dopuści zestaw o wymienionym poniżej składzie:

serweta z otworem i przylepcem	1	L2	200x180	PROST.	20x10
serweta przeznaczona pod pośladki	1	L2	90x75		
pokrowiec na nogę	2	L2	120x75		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 23 dotyczące Zadania 60 poz1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do operacji stawu biodrowego o składzie:

- serweta na stolik instrumentariuszki 190x150cm
- serweta na stolik Mayo 145x80cm
- serweta z przylepcem 300x180
- serweta 260x240 cm ze wzmocnieniem i wycięciem typu „U” w rozmiarze 100x10cm 1 szt.
- serwety 90x75 cm 1 szt.
- pokrowiec na kończynę 120x37 cm
- taśma na włókninie 50x9cm 2szt.
- ręczniki celulozowe w rozmiarze 50x40cm 4szt.
- serweta w rozmiarze 200x150cm

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m².

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 24 dotyczące Zadania 60 poz 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do operacji stawu biodrowego o składzie:

Serweta z przylepcem	1 szt.	L2	260x240
Serweta z przylepcem	1 szt.	L2	240x150
Pokrowiec na nogę	1 szt.	L2	120x37
Kieszka na płyny z kształtką	1 szt.	PE-1K	40x30
Taśma medyczna	6 szt.	Spunlace	50x9
Serweta na stół instrum.	1 szt.		190x150
Serweta na stolik Mayo	1 szt.		145x80
Serwetki do rąk	2 szt.	Włók. Kom.	40x20

Serwety z przylepcem wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56g / m², o odporności na przenikanie cieczy równej 250 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min 75N i chłonności 570%, serweta sterylna na stolik Mayo wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², wytrzymałości na zerwanie na sucho i mokro min 15N/5cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 40 kPa, barierowość dla wody min 30cm H₂O, serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gramaturze 40g.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 25 dotyczące Zadania 67 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny o gramaturze 35 g/m², strefa krytyczna o gramaturze 75 g/m². Bariery laminat (PE+PP) umieszczony od zewnętrznej strony fartucha na jego przodzie i w rękawach, umożliwia użycie wyrobu podczas długich i mokrych operacji. Konstrukcja fartucha pozwala na dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Fartuch pakowany w papier krepowany z dwoma ręczniczkami?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 26 dotyczące Zadania 67

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35g/m², dodatkowo wzmocniony włókniną foliowaną o gramaturze 40g/m² w części przedniej i na rękawach, złożenie typu book folded umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów – u góry, z tyłu jest zapinany na rzep, troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, później na „czysto” specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny, rękawy proste nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłującym pot, podwójnie opakowanie- torebka papierowo foliowa z dwoma samoprzylepnymi naklejkami do archiwizacji dokumentów zawierającymi nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikacje producenta oraz dodatkowe owinięcie w papier krepowy, zapakowany z dwoma ręczniczkami z niepylnej włókniny kompresowej w rozmiarze 40cm x 20 cm, fartuch przeznaczony do operacji z dużą ilością płynów, zgodny z normą PN EN 13795 1, 2, 3, w rozmiarach, L, XL, XXL (długość fartuchów L-125cm, XL- 140cm, XXL- 155cm) ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 27 dotyczące Zadania 70, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Elementy w twardym blistrze:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1 szt.
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x560cm; średnica 5cm	1 szt.
Rękawice nitrylowe	M	2 szt.
Tupfer kula 17N	20x20 cm	5szt.
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5 cm	8 szt.
Pęseta plastikowa		1 szt.
Pean plastikowa	14 cm (+/- 0,3)	1 szt.
Pojemnik plastikowy		1 szt.

Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym:

Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1 szt.
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1 szt.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 28 dotyczące Zadania 72, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o składzie:

Serweta z laminatu FB	45x75 cm	1 szt.
Serweta z laminatu L2 45x75 cm z otworem o średnicy 8 cm i przyłepcem wokół otworu	45x75cm; średnia 8cm	1 szt.
Kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10szt.
Tupfer kula 17N	20x20cm	10szt.
Pęseta plastikowa		1 szt.
Strzykawka 10ml	10 ml	1 szt.
Strzykawka 20ml	20ml	1 szt.
Igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1 szt.
Igła 08x40mm	0,8x40mm	1szt.
Ostrze nr 11	Nr 11	1 szt.
Imadło metalowe		1 szt.

Serweta z laminatu FB wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 42 g/m², wytrzymałość na zerwanie min. 10N/5cm, barierowość dla wody min 700mm H₂O.

Serweta z L2- wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56 g/m² o odporności na przenikanie cieczy równej 250cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 150 kPa,



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min. 75N i chłonności 570%, zgodnie z normą EN 13795-1-2-3, opakowanie z odklejaną etykietą umożliwiającą identyfikację zestawu z numerem serii, data ważności oraz identyfikacją producenta?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 29 dotyczące Zadania 73

Czy Zamawiający wymaga, by podkład chłonny z pulpy celulozowej o rozmiarze 60x60 cm był o chłonności minimum 1400g ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 30 dotyczące Zadania 78 poz.1

Czy zamawiający dopuści przykrycie dla pacjenta z polipropylenu w kolorze niebieskim?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 31 dotyczące Zadania 79 poz 1-3

Czy należy zaoferować wyrób posiadający falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz, co zapobiega wyciekom?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 32 dotyczące Zadania 79, poz 1-3

czy należy zaoferować wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 33 dotyczące Zadania 79 poz 1-3

czy należy zaoferować pieluchy w opakowaniu zbiorczym a30 szt?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 34 dotyczące Zadania 80 poz 1

Czy należy zaoferować pieluchy z wycięciem na pępek?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 35 dotyczące Zadania 82 poz 1-2:

Czy Zamawiający dopuści elastyczne majtki siatkowe wykonane z poliestru i elastanu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 36 dotyczące Zadania 83

Czy zamawiający dopuści fartuchy niesterylne z włókniny o gramaturze min. 20g/m²?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 37 dotyczące Zadania 86

Czy zamawiający dopuści jednorazowe włókninowe ubranie dwuczęściowe o gramaturze 45/m², składające się z bluzy i spodni zapakowanych razem, bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic, krawędzie obszyte zabezpieczone przed strzępieniem, spodnie luźne z trokami?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 38 dotyczące Zadania 89

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, zaprojektowane tak, by chronić skórę dłoni osoby pielęgnującej, niepodfoliowane wykonane z włókniny?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 39 dotyczące Zadania 89

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki wykonane z miękkiego i chłonnego materiału, zaprojektowane tak, by chronić skórę dłoni osoby pielęgnującej, podfoliowane wykonane z celulozy?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 40 dotyczące Zadania 95

Czy zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na kamerę w rozmiarze 13x235 cm składany teleskopowo, z jednej strony wyposażony w kartonik z drugiej zaś w taśmę lepłą co ułatwia aplikację na urządzeniu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 41 dotyczące Zadania 98

Czy zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni o wymiarze 45cm x 75 cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 42 dotyczące wymaganych dokumentów:

Czy zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu, czy też oświadczenia, że wykonawca dokumenty takie posiada przedstawi je na każde żądanie zamawiającego ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia oświadczenia, że wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu i , że przedstawi je na każde żądanie zamawiającego.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 43 dotyczące zapisów umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 44 dotyczące zapisów umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zapłata za zamówiony towar następowała w ciągu 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie 45 dotyczące zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 7 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% pod warunkiem uzgodnienia zmian cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmian cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie 46 dotyczące Zadania 19 - Materiały Opatrunkowe, ilość pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części.

Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 47 dotyczące Zadania 29


Czy Zamawiający w pakiecie 29 dopuści tampony donosowe o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w posługiwaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

Struktura i skład

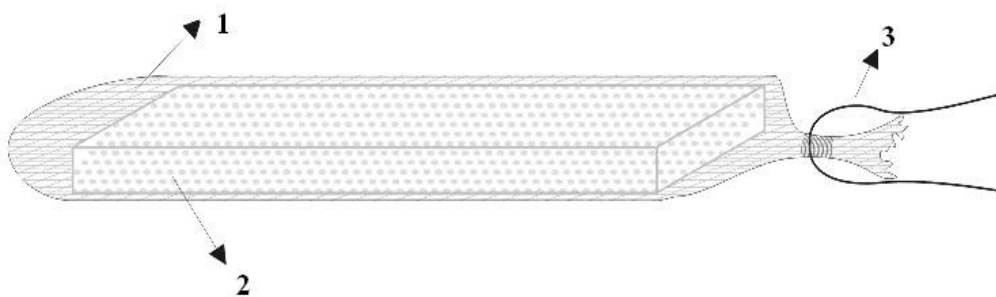

1—rozpuszczalna gaza hemostatyczna 2—gąbka 3—sznurek

Rozpuszczalna gaza hemostatyczna pochodna sodowa karboksymetylocelulozy

Gąbka alkohol poliwinylowy

Sznurek nić jedwabna



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 48 dotyczące Zadania 29

Czy Zamawiający w pakiecie 29 dopuści tampony donosowe o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki (alkohol poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji.

Cechy:

- *wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie*
- *unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty*
- *miękką gąbką zapewnia równorzędną wzmocnienie i ucisk*
- *utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany*
- *nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego*
- *łatwość w posługiwaniu się*
- *bezbolesna aplikacja i usuwanie*
- *bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych*
- *sznureczek*

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 49 dotyczące projektu UMOWY

Czy Zamawiający ma możliwość odbioru towaru na paletach?

Odpowiedz

Zamawiający ma możliwość przyjęcia towaru na paletach do magazynu natomiast nie posiada stosownego sprzętu do rozładunku i przewozu palet.

Pytanie 50 dotyczące Zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 51 dotyczące Zadania 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch na rolce w opakowaniach a'90 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 52 dotyczące Zadania 46 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne dodatkowo wzmocnione nitkami gwarantującymi trwałość wykonania o gramaturze min 51 g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 53 dotyczące Zadania 57 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o składzie :

1 serweta na stół instrumentariuszki	150 x 190cm; warstwa chłonna 75x190cm
1 serweta na stół Mayo	80 x 145cm; warstwa chłonna 60x145 cm
1 serweta samoprzylepna	180 x 150cm; warstwa chłonna 180x150 cm
1 serweta samoprzylepna	150 x 240cm warstwa chłonna 150x240 cm
2 serwety samoprzylepne dłuższym boku o szerokości 6cm)	75 x 90cm; warstwa chłonna 75x90 cm (przyklepic na
2 włókninowe OP taśmy	10 x 50
2 ręczniki	40 x 40

Zestaw o gramaturze 62g/m² i odporności na przenikanie cieczy min 145cm H₂O.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 54 dotyczące Zadania 60

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie:

1 serweta z wycięciem U-kształtnym	200 x 300 cm
1 serweta na stół instrumentariuszki	150 x 190cm
1 serweta 75 x 90 cm	
1 serweta 150 x 200 cm	
1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu	
1 serweta na stół Mayo	80 x 145 cm
2 ręczniki do rąk	40 x 40
1 osłona na kończynę	35 x 120
2 OP Taśma	10 x 50

Materiał obłożenia spełniają wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.

Serwety wykonane z materiału trzywarstwowego o gramaturze 75g/m² i odporności na przenikanie cieczy min 300cm H₂O. Chłonność 600%. Wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 80 kPa, wytrzymałość na



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

rozrywanie na mokro min 80 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.

Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 55 dotyczące Zadania 67

Prosimy o odstąpienie od wymagania odporności fartucha na działanie alkoholi.

Odpowiedz

Zamawiający odstąpienie od wymagania odporności fartucha na działanie alkoholi.

Pytanie 56 dotyczące Zadania 67

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS, zapięcie na górze w formie rzepu, takie jak stosowane dotychczas?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 57 dotyczące Zadania 83

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z włókniny o gramaturze min. 20g/m²

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 58 dotyczące Zadania 85


Prosimy Zamawiającego o określenie składu (wraz z wymiarami) zestawu małego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza asortyment zaproponowany przez Wykonawcę.

Pytanie 59 dotyczące Zadania 89

Czy Zamawiający dopuści gąbkę do mycia pacjenta z miękkich włókien poliestru o gramaturze 100 g/m², nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 w rozmiarze 12 x 20cm (rysunek poniżej)?



Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 60 dotyczące Zadania 89

Czy Zamawiający dopuści rękawice do mycia skóry wykonana z dwóch warstw włókien: molton 100g nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz molton 100g bez mydła w rozmiarze 17 x 24,5cm (rysunek poniżej)?



Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 61 dotyczące Zadania 89

Czy Zamawiający dopuści gąbkę do wycierania po myciu do sucha wykonana z dwóch warstw włókniny molton 77g w rozmiarze 16,5 x 24,5cm (rysunek poniżej)?



Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 62 dotyczące Zadania 90

Czy Zamawiający ma na myśli ochraniacze włókninowe, czy foliowe?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza ochraniacze włókninowe jak i foliowe

Pytanie 63 dotyczące Zadania 91

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki w rozmiarze 103cm x 115cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 64 dotyczące 92

Czy Zamawiający dopuści zarękawek nieprzemakalnego laminatu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzaska 44, 78-600 Wałcz

Telefon: 261 47 28 61-63; **Fax:** 261 47 28 61-63

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Regon 570544566 NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002